

Llamada a pre-qualificación técnica y entrega de 30 muestras (o más)

Especificaciones son separados entre criterios cualitativos (evaluación cumple/no cumple) y criterios cuantitativos (metrología y endurance, evaluación cuantitativa)

Evaluación de la conformidad de las muestras con las especificaciones, descalificación de los que no cumplen con requisitos cualitativos

Evaluación de metrología inicial (EMP) y desvío

Ensayo de desgaste acelerado 30 ciclos = un año, evaluación del EMP

Proyección lineal de la evolución de EMP inicial-año 1

Cálculo Valor Actualizado Neto (función de montos facturados, tipo de cambio, costo del capital) sobre 7 años, versus el medidor ideal (EMP=0)

El VAN + puntaje atribuido al desvío de EMP estarán aplicados al precio para obtener el precio normalizado

Estos datos no son comunicados a los proveedores antes de la oferta económica

Llamada a presentación de oferta económica

Comparación de los precios normalizados

Facturacion Anual 240 pesos argentinos 80
 Tipo de cambio 3 pesos / USD

	Nuevo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
EMP Medidor 1	98,5	98	97,5	97	96,5	96	95,5	95
Delta Cash Flow	-1,2	-1,6	-2	-2,4	-2,8	-3,2	-3,6	-4


Costo del Capital 12%

Valor Actualizado Neto vs medidor ideal (\$11,75) USD 12,65

STDEV EMP 0,3
 Ponderacion desvio 3 USD por punto de desvio
 Puntaje desvio 0,9 USD

Precio Ofertado 29,4 USD

Precio Normalizado \$42,05 USD

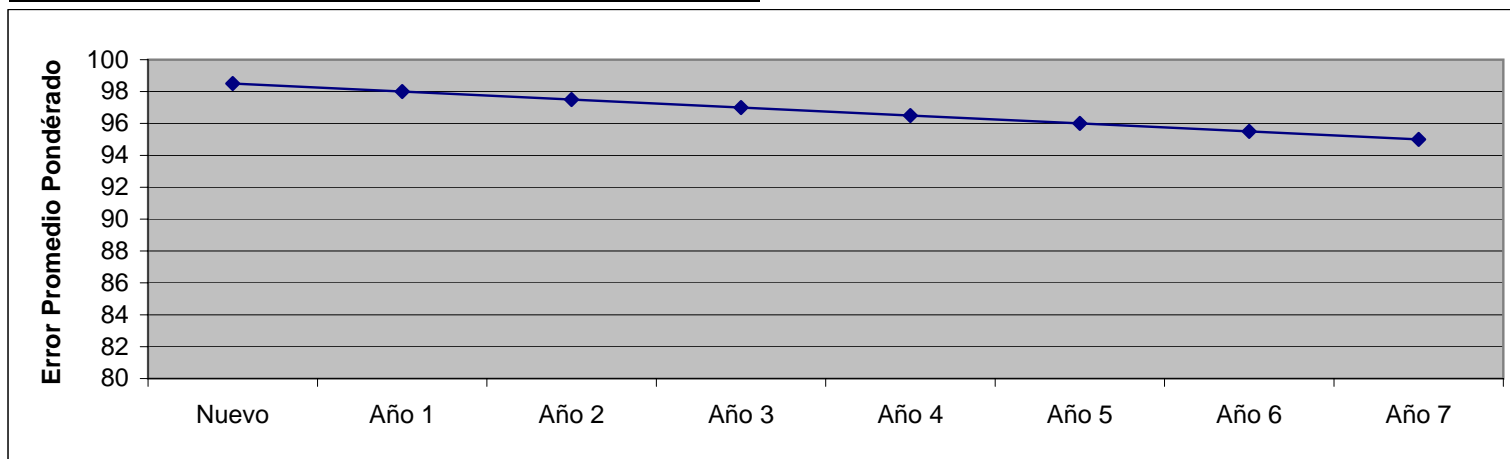

Facturacion Anual 240 pesos argentinos
 Tipo de cambio 3 pesos / USD

	Nuevo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
EMP Medidor 1	96,5	95	93,5	92	90,5	89	87,5	86
Delta Cash Flow	-2,80	-4,00	-5,20	-6,40	-7,60	-8,80	-10,00	-11,20

Costo del Capital 12%

Valor Actualizado Neto vs medidor ideal (\$31,28) USD

STDEV EMP 0,8

Ponderacion desvio 3 USD por punto de desvio

Puntaje desvio 2,4 USD

Precio Ofertado 20,23 USD

Precio Normalizado \$53,91 USD

